PAC Nº: 271.047

ADENDA Nº 05/2014

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2014 "*ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES*"** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 23 de mayo de 2014 Hora: hasta las 08:50 a.m. horas
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: 23 de mayo de 2014 Hora: 09:00 a.m. horas

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

➢ Se verificarán la presentación de los Documentos de Carácter No Sustancial o Formal:

Donde dice:

- Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la carta de autorización original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Publica. Para los Gases Especiales: Óxido Nitroso Medicinal, Óxido Nítrico Medicinal y Anhídrido Carbónico, el oferente podrá presentar una Declaración Jurada de Capacidad de Provisión en Tiempo y Forma, en lugar de la Autorización del Fabricante.

Debe decir:

- Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la carta de autorización original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Publica. Para los Gases Especiales: Óxido Nitroso Medicinal, Óxido Nítrico Medicinal y Anhídrido Carbónico; la empresa oferente también deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertado, a dicho efecto deberá presentar la carta de autorización original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Pública.



SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SE AGREGAN LOS SIGUIENTES DATOS A LA PRESENTE SECCIÓN:

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS "DR. PROF. MANUEL GIAGNI "	
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Líquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTODE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	I R.S. CONCEPCION
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.

20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	II R.S. SAN PEDRO
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A

	SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	III R.S. CORDILLERA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	IV R.S. GUAIRA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.

Sergio Barrios

75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	V R.S. CAAGUAZU
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	VI R.S. CAAZAPA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	VII R.S. ITAPUA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.



5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	VIII R.S. MISIONES
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	IX R.S. PARAGUARI
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	X R.S. ALTO PARANA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.

Sergio Barrios
Director General

5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	XI R.S. CENTRAL
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	XII R.S. ÑEEMBUCU
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	XIII R.S. AMAMBAY
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.

1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	XIV R.S. CANINDEYU
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	XV R.S. PDTE HAYES
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	XVI R.S. BOQUERON
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador

Dr. Arq. Sergio Barrios
Director General

1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	XVII R.S. ALTO PARAGUAY
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts.

	Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	XVIII R.S. CAPITAL
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL SAN JORGE
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.



1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL DE LAMBARE
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL DE LOMA PYTA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros

1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	HOSPITAL DE ÑEMBY
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS

1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL DE ITA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO

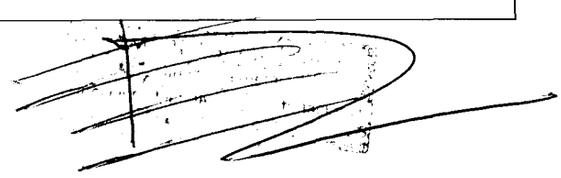

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL DE VILLETA
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.

5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES

5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.

5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMASDE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FDO .DE LA MORA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MARIANO ROQUE ALONSO
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.B978
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BO SAN PABLO
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.

20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
HOSPITAL DE SAN LORENZO	
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
CANTIDAD	**Equipos en Comodato del Proveedor**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BO OBRERO
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.

5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.

Sergio Barrios
Director General

5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS

4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	SEME
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
30	Cilindros de Acero de Alta presión para Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL DEL INDIGENA
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	CRUZ ROJA
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	INERAM
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.

4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO
	BIENES SOLICITADOS EN COMODATO
	HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.B1361
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS

BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	LABORATORIO CENTRAL
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	Cilindros de Acero de Alta presión para Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para Nitrogeno Medicinal
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
BIENES SOLICITADOS EN COMODATO	
	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARA'Y
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tanque Criogénico para Oxigeno Liquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros
1	Vaporizador Atmosférico para oxigeno, montado en tubos aletados de Aluminio, con capacidad mínima de 70 m3/hora.
1	Base de hormigón armado para tanque de Oxigeno y Vaporizador
1	Cuadro de doble regulación de presión de línea; para tanque de O2 compuesto por: 2 válvula de seguridad de 85 psi, 1 válvula de seguridad de 280 psi, 2 válvula de retención, 2 filtros criogénicos, 4 válvula esférica de 1/2, 2 reguladores con manómetros.
1	Panel de alarma Operacional, audiovisual para Oxigeno, con botón de Test y Silencio.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Carbónico Medicinal de 20 a 30 Kg de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Gas Acetileno Industrial de 4 a 9 Kg de capacidad.
75	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxígeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
20	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Aire Comprimido Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Nitrógeno Medicinal de 6 a 7 m3 de capacidad.
5	Cilindros de Acero de Alta presión para contener Oxido Nitroso Medicinal de 29 a 33 Kg de capacidad.
15	Cilindros de Acero de Alta presión Portátiles; para contener Oxígeno Medicinal de 1 m3 de capacidad.
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA AIRE MEDICO MEDICINAL
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERIAS, TOMAS y GENERADORES PARA VACIO MEDICO MEDICINAL
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FLUXOMETROS CON HUMIDIFICADOR EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
1	CAUDALIMETRO A LA SALIDA DEL TANQUE, GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1.000	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS (1.000 mts. Lineales)
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSOLAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
80	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
4	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
20	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE SECTORIZACION EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE VACIO CON SUS FRASCOS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
50	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALONES
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES Y A SER INSTALADAS
5	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MANIFOLD EXISTENTES Y A SER INSTALADOS
10	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO A LAS CONEXIONES DE MANGUERAS PARA OXIGENO, AIRE, OXIDO NITROSO

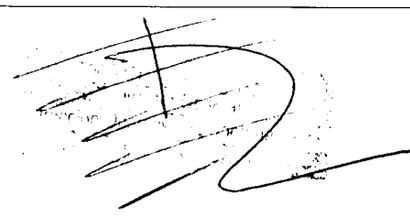

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I
DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

I) Documentos Adicionales.		
• Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC). • Declaración Jurada vigente que garantice que el Oferente es representante o distribuidor de la marca, o en su defecto, que esté debidamente autorizado a comercializar los bienes que oferta. (Formulario N° 4) • Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la carta de autorización original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Publica. Para los Gases Especiales: Óxido Nitroso Medicinal, Óxido Nítrico Medicinal y Anhídrido Carbónico; la empresa oferente también deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertado, a dicho efecto deberá presentar la carta de autorización original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Pública. • Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; • Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. • Copia Autenticada de la Resolución y/o Certificado de Apertura Vigente, o en su efecto Constancia de Renovación de Apertura del local en tramite; como fraccionadora, envasadora y/o distribuidoras de gases medicinales expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, (Resolución Nº. 208 /09 de fecha 23/04/2009 del MSP y BS.) • Copia Autenticada del Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufacturas y Control (BPM y C) vigente expedidos por la DNVS, conforme a la Resolución S. G. Nº 208 del 23/04/2009 del MSPyBS • Declaración Jurada de conocer el sitio donde ofertará la provisión de Gases medicinales con las instalaciones requeridas. • Adjuntar lista de Equipos y accesorios a ser instalado en cada dependencia Sanitaria en caso de ser adjudicado en carácter de Declaración Jurada. • Declaración Jurada de Capacidad de proveer en comodato, de todo lo necesario para el buen funcionamiento de los tanques y balones en los diferentes centros asistenciales mientras dure el contrato. Así como del mantenimiento, reparación y correcto funcionamiento de todos los equipos y accesorios instalados en comodato, correspondiente al Tanque Criogénico así como de los balones. • La empresa adjudicada a través de una Declaración Jurada se compromete a retirar sus equipos una vez que el nuevo oferente adjudicado haya instalado sus equipos e iniciado la provisión, en caso de no ser nuevamente adjudicado. • El proveedor deberá detallar en su oferta métodos o sistemas de control de calidad y pureza de los gases a ser proveídos (emitido por el Químico Farmacéutico o Regente de la firma oferente), • Con cada entrega el proveedor deberá presentar copia del certificado de pureza de los gases rubricada, dichos documentos podrán ser verificados en cualquier momento de la vigencia del contrato por personal técnico calificado del MSPBS.- • Para que la aplicación de dicho margen de preferencia sea efectiva, el oferente deberá presentar en carácter de declaración jurada el Certificado de Origen Nacional expedido por la Dirección General de Desarrollo Empresaria, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, según lo establecido en el Articulo 3 inc. C) del Decreto 9649 de fecha 7 de septiembre de 2012. • Planilla de precios en Excel versión 2003 o anterior impresa y en medios magnéticos • Los oferentes que presenten los Insertos en otro idioma, deberán presentar la traducción correspondiente al español (fundamentos o principio, contenido y composición, procedimientos, valores de referencias, etc.) de todos los productos ofertados. • Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario. • Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario.		

***Documentos Sustanciales**

Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "ACTIVOS".

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.



Asunción, 09 de mayo de 2014